

GESTION DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-24
Versión: 01

CERTIFICACION CHAT
CONTRATACION ELECTRONICA

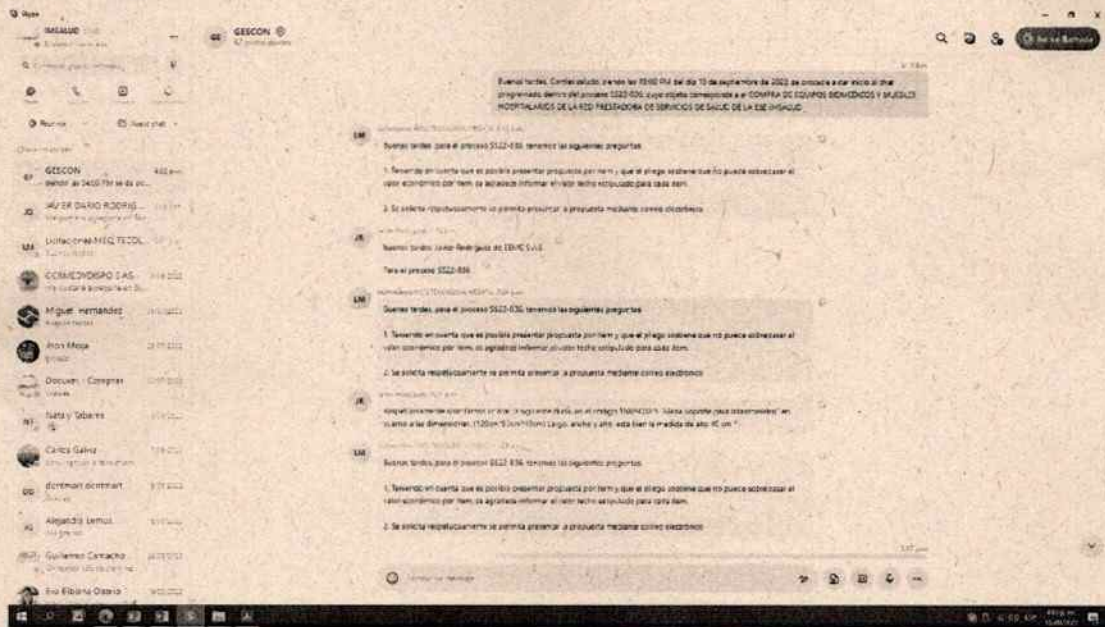
Fecha: 06/05/2022

EL SUBGERENTE ATENCION EN SALUD

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS22-836, se realizó el chat del grupo **GESTIÓN CONTRACTUAL – GESCON**, Cuenta Skype: **GESCON**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:



IMSALUD: Buenas tardes, Cordial saludo, siendo las 03:00 PM del día 13 de septiembre de 2022, se procede a dar inicio al chat programado dentro del proceso SS22-836, cuyo objeto corresponde a el COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MUEBLES HOSPITALARIOS DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

Licitaciones MEQ TECOLOGIA MEDICA, 3:12 p.m. Buenas tardes, para el proceso SS22-836, tenemos las siguientes preguntas:

1. Teniendo en cuenta que es posible presentar propuesta por item y que el pliego sostiene que no puede sobrepasar el valor económico por item, se agradece informar el valor techo estipulado para cada ítem.
2. Se solicita respetuosamente se permita presentar la propuesta mediante correo electrónico

Javier Rodriguez, 3:15 p.m. buenas tardes, Javier Rodriguez de EEMC S.A.S Para el proceso SS22-836

Licitaciones MEQ TECOLOGIA MEDICA, 3:20 p.m. Buenas tardes, para el proceso SS22-836, tenemos las siguientes preguntas:

1. Teniendo en cuenta que es posible presentar propuesta por ítem y que el pliego sostiene que no puede sobrepasar el valor económico por ítem, se agradece informar el valor techo estipulado para cada ítem.

2. Se solicita respetuosamente se permita presentar la propuesta mediante correo electrónico

Javier Rodriguez, 3:21 p.m. Respetuosamente solicitamos aclarar la siguiente duda, en el código 166090.075 "Mesa Soporte para Infantometro" en cuanto a las dimensiones, (120cm*50cm*40cm) Largo, ancho y alto, esta bien la medida de alto 40 cm ?

Licitaciones MEQ TECOLOGIA MEDICA, 3:28 p.m. Buenas tardes, para el proceso SS22-836, tenemos las siguientes preguntas:

1. Teniendo en cuenta que es posible presentar propuesta por ítem y que el pliego sostiene que no puede sobrepasar el valor económico por ítem, se agradece informar el valor techo estipulado para cada ítem.

2. Se solicita respetuosamente se permita presentar la propuesta mediante correo electrónico

3:37 p.m. buenas tardes @Javier Rodriguez respecto al ítem Mesa soporte para Infantometro, la altura es de 40 CM, tal como quedo establecido en el acápite segundo del anuncio publico denominado Especificaciones Técnicas


3:48 p.m. para @Javier Rodriguez para el punto 1. Teniendo en cuenta que por política institucional la ESE IMSALUD busca la mejor oferta entre los proponentes, esto es, que los oferentes ofrezcan el mejor precio dentro del proceso. Es por ello que la ESE IMSALUD no referencia los precios de los ítems, pues son los proponentes los encargados de dar el mejor costo para la entidad.

Licitaciones MEQ TECOLOGIA MEDICA, 3:50 p.m.

@Javier Rodrigue
IMSALUD, Hoy a la(s) 3:48 p.m
Gracias y por favor la respuesta a la pregunta 2

3:50 p.m. Para el punto 2 De acuerdo al anuncio el numeral 9.8 del capitulo oferta establece: 9.8 En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación.

en este sentido , es posible enviar la propuesta a los correos dispuestos en el primer folio, pero necesariamente deben llegar de forma física antes de la evalaucion


	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 01
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 06/05/2022

Licitaciones MEQ TECOLOGIA MEDICA, 3:57 p.m. Las básculas pesabebes las requieren grado médico?

4:01 p.m. @Licitaciones MEQ TECOLOGIA MEDICA las basculas pesabebes requieren grado medico, así lo establece la resolución 3100 del 2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección social

siendo las 04:00 PM se da por terminado el chat del proceso SS22-836, esperando haber resueltos las inquietudes realizadas.

Se expide a los trece (13) días del mes de septiembre de 2022


JORGE HUERTAS MORENO
Subgerente Atención en Salud

Proyectó: Yeferson Vergel Contreras – Abogado Apoyo Gescon 