


	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 01
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 06/05/2022

EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SA22-918, se realizó el chat del grupo **GESTIÓN CONTRACTUAL – GESCON**, Cuenta Skype: **GESCON**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:

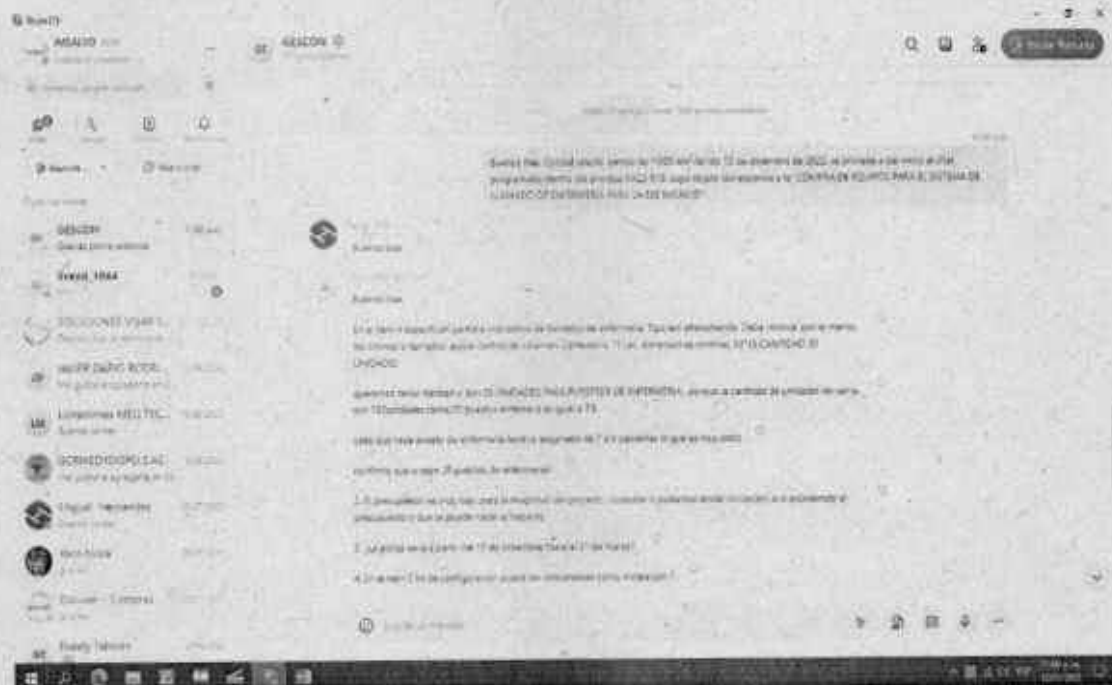

IMSALUD: Buenos días, Cordial saludo, siendo las 10:00 AM del día 12 de diciembre de 2022, se procede a dar inicio al chat programado dentro del proceso SA22-918, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PARA LA ESE IMSALUD"


Miguel, 10:00 a.m.

Buenos días

live:id_1044, 10:15 a.m.

Buenos días

En el ítem 4 especifican pantalla indicadora de llamados de enfermería. Tipo led alfanumérico. Debe mostrar por lo menos los últimos 6 llamados. ajuste control de volumen. Conexión a 11 vac. dimensiones mínimas 30*15 CANTIDAD 20 UNIDADES

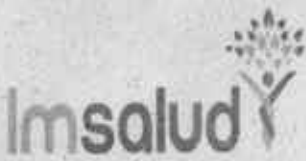	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 01
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 06/05/2022

queremos tener claridad si son 20 UNIDADES PARA PUESTTOS DE ENFERMERIA , porque la cantidad de unidades de cama son 150unidades cama/20 puestos enfermeria es igual a 7.5

osea que cada puesto de enfermeria tendria asiganado de 7 a 8 pacientes lo que es muy poco

confirma que si sean 20 puestos de enfermeria?

2. El presupuesto es muy bajo para la magnitud del proyecto. consultar si podemos enviar cotización aun excediendo el presupuesto o que se puede hacer al respecto

3. ¿La póliza seria a partir del 13 de diciembre hasta el 31 de marzo?

4. En el ítem 5 kit de configuracion puede ser interpretado como instalacion ?

10:26 a.m.

IMSALUD : @live:id_1044 a la primera pregunta, si esto obedece que son para diferentes IPS

IMSALUD: @live:id_1044 se confirman que son 20

live:id_1044, 10:28 a.m.

@live:id_1044

Hoy a la(s) 10:26 a.m.

son en la misma ciudad? porque tengo entendido que se deben incluir los costo adicionales

10:30 a.m.

IMSALUD: @live:id_1044 respecto al punto 2. el valor de la propuesta no puede exceder el presupuesto oficial estimado del contrato. toda vez incurriría en una causal de rechazo No. 14 establecida acápite 5 del anuncio publico denominado oferta

10:37 a.m.

IMSALUD: @live:id_1044 respecto a la tercera pregunta la vigencia de la póliza de la seriedad de la oferta es de noventa días contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta. si

10:46 a.m.

IMSALUD: @live:id_1044 a la pregunta cuarta los kits de configuración son hardware y software son necesarios para que Imsalud autónomamente sin ayuda de nadie, sin ningún tipo de soporte pueda instalar y reconfigurar los equipos, el proceso incluye solo suministro, es una compra no es una instalación.

IMSALUD: @live:id_1044 recuerda que en el acápite dos del anuncio publico se establece lo relacionado en la pregunta cuatro

	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 01
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 06/05/2022

IMSALUD: @live: id_1044 en el acápite quinto del anuncio publico numeral 29 establece que el valor de la oferta económica deben incluir los costos directos e indirectos que se ocasionen incluyendo el IVA, cuando a ello haya lugar

IMSALUD: @live: id_1044 dando alcance a la repuesta del punto dos se establece que efectivamente el presupuesto fue obtenido por las cotizaciones del mercado.


11:00 a.m.

IMSALUD: siendo las 11:00 AM se da por terminado el chat del proceso SA22-918, esperando haber resuelto las inquietudes realizadas.

live: id_1044, 11:00 a.m.

Gracias por la asesoria

Se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022

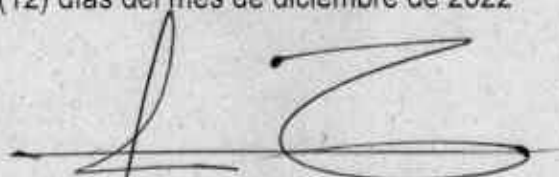

ADOLFO ISAURO YANGO JOSE RODRIGUEZ BELTRAN
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyectó: Luz E. Escalante Ramirez- apoyo Profesional gescom

