
	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 02
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 01/06/2023

EL SUBGERENTE DE ATENCION EN SALUD (C)

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS23-1222, se realizó el chat del grupo **GESTIÓN CONTRACTUAL – GESCON**, Cuenta Skype: **GESCON**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:

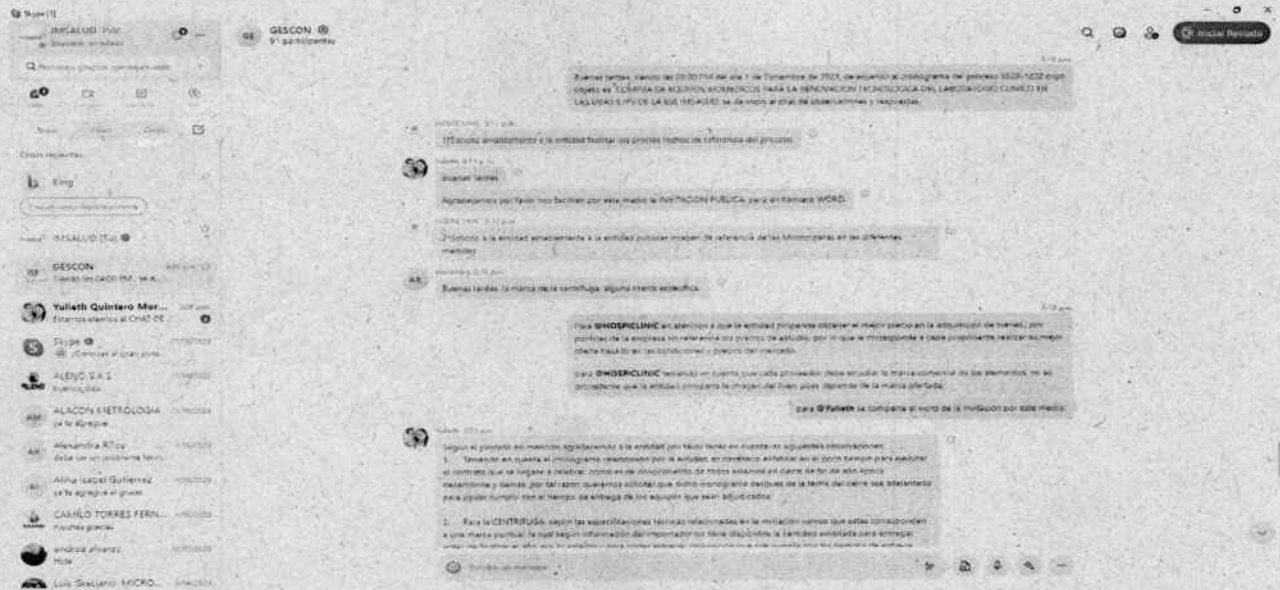

ESE IMSALUD, 03:00 p.m.

Buenas tardes, siendo las 03:00 PM del día 1 de Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma del proceso SS23-1222 cuyo objeto es COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL LABORATORIO CLINICO EN LAS UBAS E IPS DE LA ESE IMSALUD, se da inicio al chat de observaciones y respuestas.

HOSPICLINIC, 3:11 p.m.

1*Solicito amablemente a la entidad facilitar los precios techos de referencia del proceso.

Yulieth, 3:11 p.m.

Buenas Tardes

Agradecemos por favor nos faciliten por este medio la INVITACION PUBLICA, pero en formato WORD.

HOSPICLINIC, 3:12 p.m.

2*Solicito a la entidad amablemente a la entidad publicar imagen de referencia de las Micropipetas en las diferentes medidas

Alexandra, 3:14 p.m.

Buenas tardes, la marca de la centrífuga, alguna marca específica.

ESE IMSALUD, 3:18 p.m.

Para @HOSPICLINIC en atención a que la entidad propende obtener el mejor precio en la adquisición de bienes , por políticas de la empresa no referencia los precios de estudio, por lo que le corresponde a cada proponente realizar su mejor oferta basado en las condiciones y precios del mercado.

para @HOSPICLINIC teniendo en cuenta que cada proveedor debe estudiar la marca comercial de los elementos, no es procedente que la entidad comparta la imagen del bien, pues depende de la marca ofertada.

	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 02
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 01/06/2023

para @Yulieth se comparte el word de la invitación por este medio:

Yulieth, 3:21 p.m.

Según el proceso en mención agradecemos a la entidad por favor tener en cuenta las siguientes observaciones:

1. Teniendo en cuenta el cronograma relacionado por la entidad, es necesario enfatizar en el poco tiempo para ejecutar el contrato que se llegase a celebrar, como es de conocimiento de todos estamos en cierre de fin de año época decembrina y demas, por tal razón queremos solicitar que dicho cronograma después de la fecha del cierre sea adelantado para poder cumplir con el tiempo de entrega de los equipos que sean adjudicados.

2. Para la CENTRIFUGA, según las especificaciones técnicas relacionadas en la invitación vemos que estas corresponden a una marca puntual, la cual según información del importador no tiene disponible la cantidad solicitada para entregar antes de finalizar el año, por lo anterior y para poder entregar otra opción que nos cumpla con los tiempos de entrega, solicitamos lo siguiente:

- Que la capacidad sea Mínima de 24 Tubos y no de 32
- Que el Control de Velocidad de Rotación este dentro del rango solicitado (1000 a 6000 rpm) mas no que sea exacto o en su defecto que se pueda ofertar un equipo con un rango de velocidad de Rotación de 1500 a 5000 rpm
- Que el control de tiempo sea de 0 a 99 min
- Que el indicador de tapa abierta, de final de ciclo y desbalance del rotor, sea de forma OPCIONAL.
- Que el interior del equipo sea construido en Acero Inoxidable o en Duraluminio, materia que igualmente es anticorrosivo.

3. Para el PIANO CONTADOR DE CELULAS solicitamos:

- Que sea Dispositivo Digital con pantalla LCD ó Pantalla de Segmentos.
- Que el equipo sea de mínimo 6 teclas incluyendo la tecla totalizadora
- Que el rango de Conteo sea de 0 a 999 o mayor
- Que las teclas sean de membraba o teclas pulsadoras.

4. Para el AGITADOR DE MAZZINI solicitamos:

- Que la capacidad de carga sea desde 0 kg a 4.5 kg o mayor
- En cuanto a la capacidad de estudios de cultivos > a 90 hoyos, no entendemos dicha especificación teniendo en cuenta que este equipo se conforma de una plataforma de agitación mas no de hoyos
- Que la visualización de tiempo sea de 1 a 999 minutos de forma continua
- Que lo Adaptable con plataforma up12 control sea de forma opcional
- Para la especificación "Tapa de Protección con base fácil de limpiar y resistente a sustancias acidas y alcalinas" vemos que dicha característica No Aplica para este equipo, ya que un Agitador de Mazzini no viene con Tapa de Protección, este consta de una base con una plataforma de Agitación, por lo tanto, solicitamos aclarar dicha solicitud.

5. Para el AGITADOR HEMATOLOGICO solicitamos:

- Que el Angulo de Agitación sea > 0 = a 19°
- Que la velocidad sea de 10 a 35 RPM o mayor

6. Solicitamos aclarar si la presente invitación es por Subasta o a menor precio

	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-24 Versión: 02
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	Fecha: 01/06/2023

ESE IMSALUD, 3:23 p.m.

para @Alexandra La entidad no solicita marca , son los proponentes que deben ofrecer el productor cumplimiento con las características solicitadas.

ANUNCIO PUBLICO CONTRATACION EQUIPOS BIOMEDICOS SS23-1222.docx

para @Yulieth al punto 1., conforme el principio de anualidad presupuestal la entidad no puede extender el termino mas allá del 31 de diciembre del 2023, en tal sentido no es procedente adelantar tiempo para la entrega de los dispositivos.

para @Yulieth al punto 2, 3, 4, 5, las condiciones comerciales externas no son competencia de la ESE IMSALUD, en tal sentido le corresponderá a los proponentes hacer sus análisis de mercado con sus proveedores e importadores, por lo tanto, la ESE IMSALUD no debe adecuarse a las condiciones técnicas de los proponentes (pretendiendo adecuarse a los bienes y marcas con que cuentan) sino por el contrario los proponentes deben adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad de acuerdo a la necesidades internas de nuestra empresa

para @Yulieth al punto 6, se realizara por menor precio.

Yulieth, 3:38 p.m.

Agradecemos por favor confirmar si la adjudicacion es por item o por el total de la oferta presentada

ESE IMSALUD, 3:40 p.m.

para @Yulieth la adjudicación se realizara por ítems.

Yulieth, 3:40 p.m.

Por otro lado hacemos énfasis en las especificaciones tecnicas del Agitador de Mazzini teniendo en cuenta que relacionan características que no aplican para este equipo, por lo tanto agradecemos revisar dicho item y aclarar las características relacionadas


ESE IMSALUD, 3:56 p.m.

para @Yulieth la entidad procederá a analizar la observación del agitador y si el evento, realizara la respectiva adenda.

ESE IMSALUD, 04:00 pm

Siendo las 04:00 PM , se da por terminado el chat de Observaciones y Respuestas del proceso SS23-1222 cuyo objeto es COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL LABORATORIO CLINICO EN LAS UBAS E IPS DE LA ESE IMSALUD.

Se expide el primer (01) día del mes de diciembre de 2023.


BEATRIZ ELENA MIRANDA PINEDO
 SUBGERENTE ATENCION EN SALUD (C)

Revisó: Kaleth Nycky Correa Gonzalez – Lider GESCON
Proyectó: Franklin Yesid Fuentes Castellanos – Apoyo Profesional - GESCON

